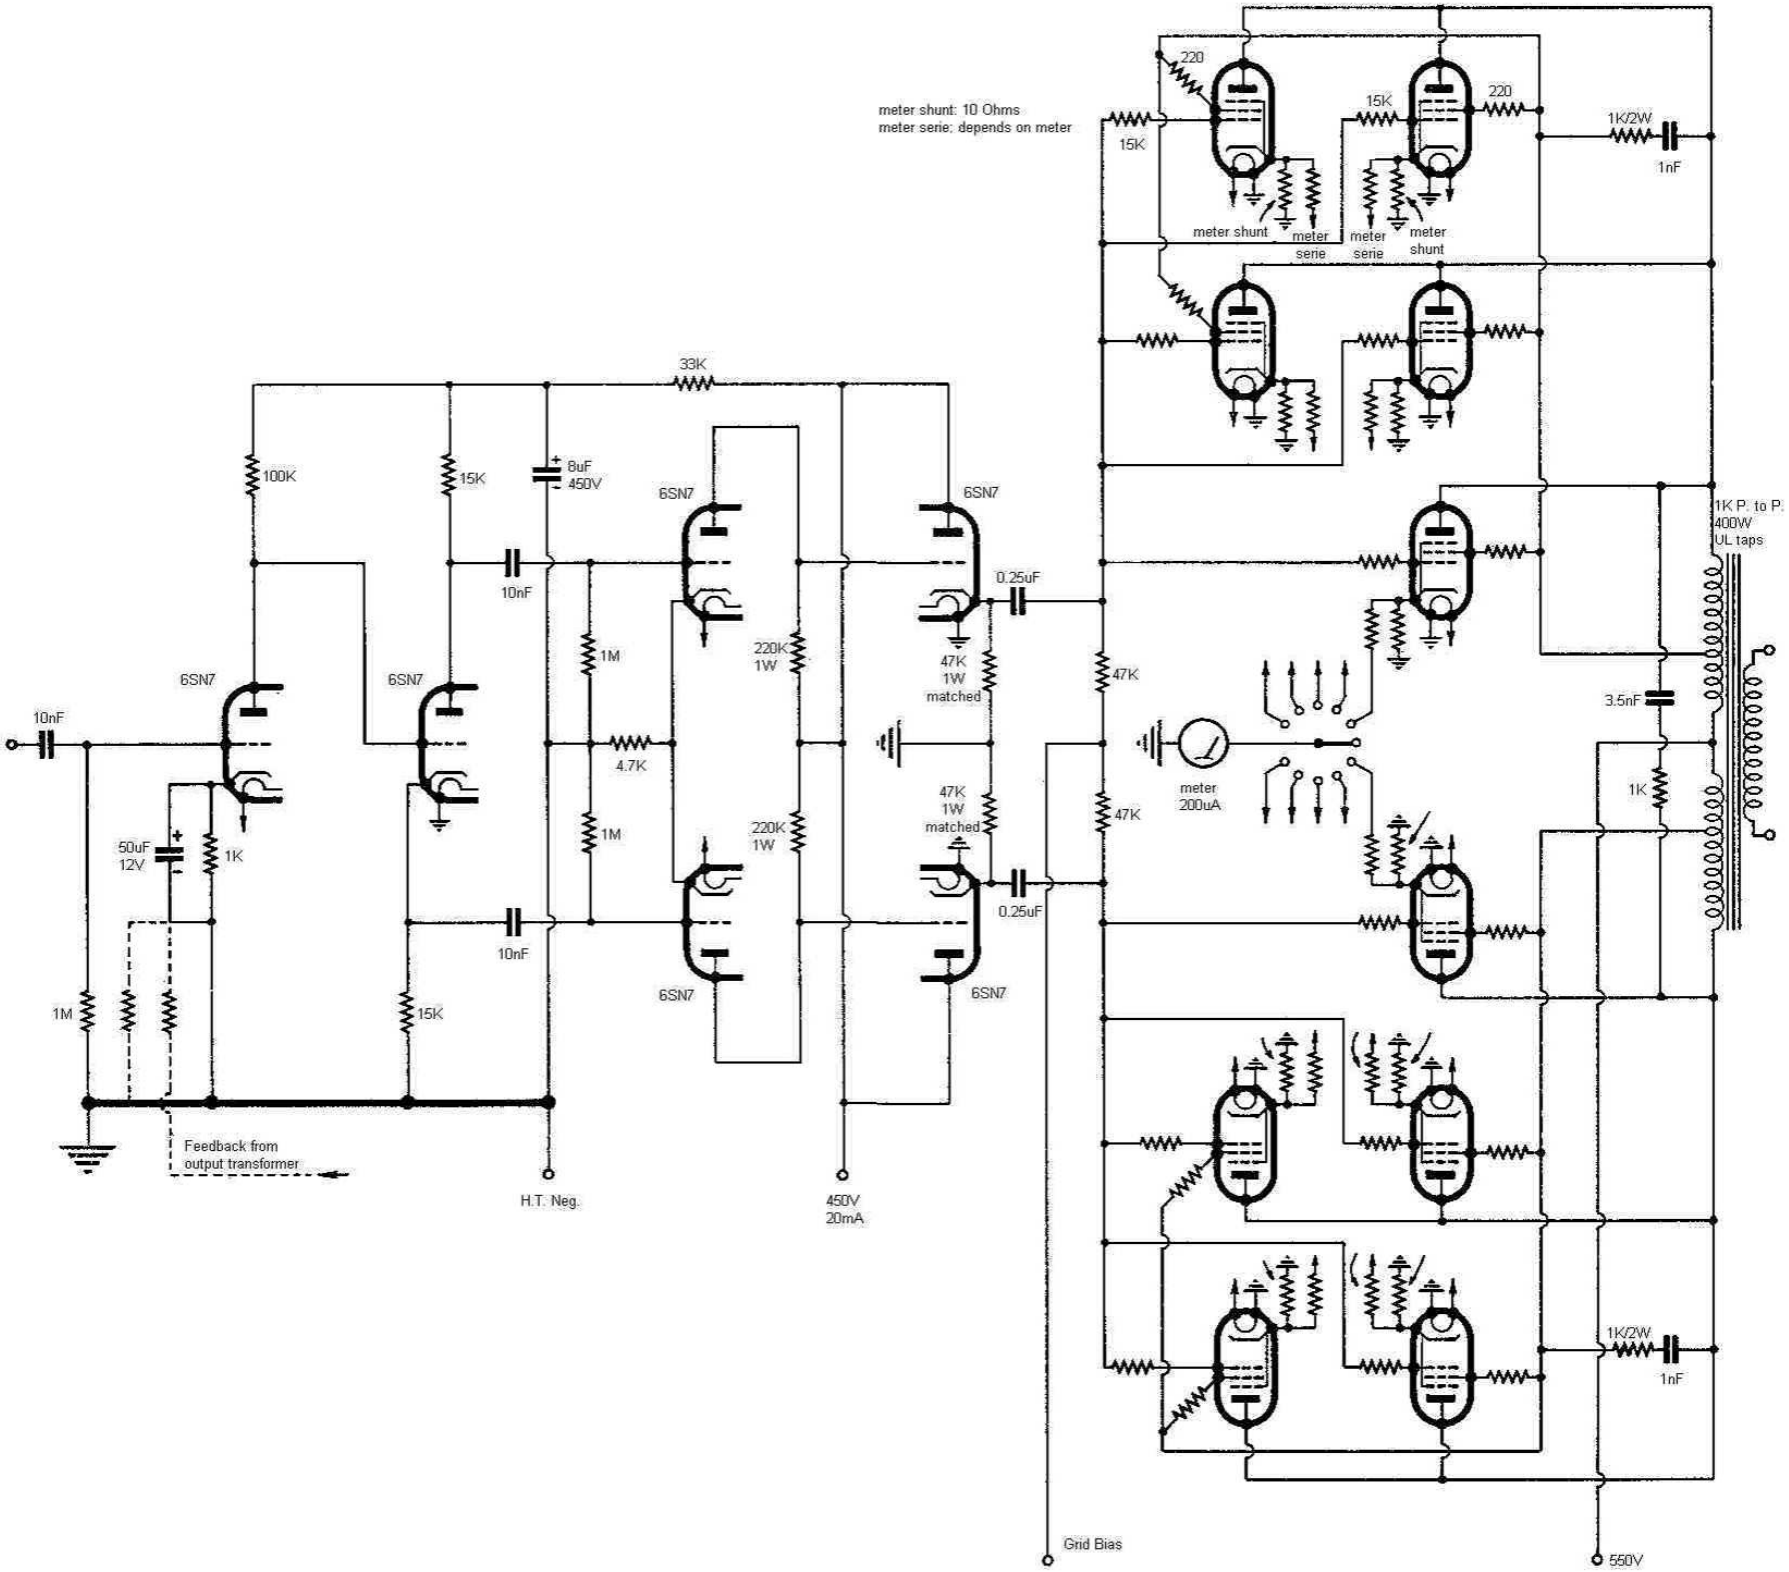
meter shunt: 10 Ohms
meter serie: depends on meter
220
15K
220
1K/2W
1nF
meter shunt
meter serie
meter serie
meter shunt
33K
100K
15K
8uF 450V
6SN7
6SN7
6SN7
0.25uF
10nF
1M
220K 1W
47K 1W matched
47K
1K P. to P. 400W UL taps
6SN7
6SN7
10nF
4.7K
47K 1W matched
47K
meter 200uA
3.5nF
1K
50uF 12V
1K
1M
220K 1W
0.25uF
10nF
6SN7
6SN7
1M
15K
Feedback from output transformer
H.T. Neg.
450V 20mA
Grid Bias
550V
1K/2W
1nF